

## 「ACTH」測定試薬変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、表記項目の測定試薬を高感度かつ、より精度の高いNon-RIA試薬へ変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

なお、この変更に伴いまして、基準値を変更させていただきます。基準値はメーカー設定値です。誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬 具

2008年6月

検査項目名 : ACTH (副腎皮質刺激ホルモン)


変更期日 : 2008年 7月 26日(土) 受付分より

### ◇変更内容

変更箇所	新	旧
測定方法	ECLIA法	IRMA法 (ビーズ固相法)
測定試薬	ロシュ社 エクルーシス試薬 ACTH	ACTH IRMA 「ミツビシ」
基準範囲	7.2~63.3 pg/mL	7~56 pg/mL

### ◇相関図

現行法と新法の相関図

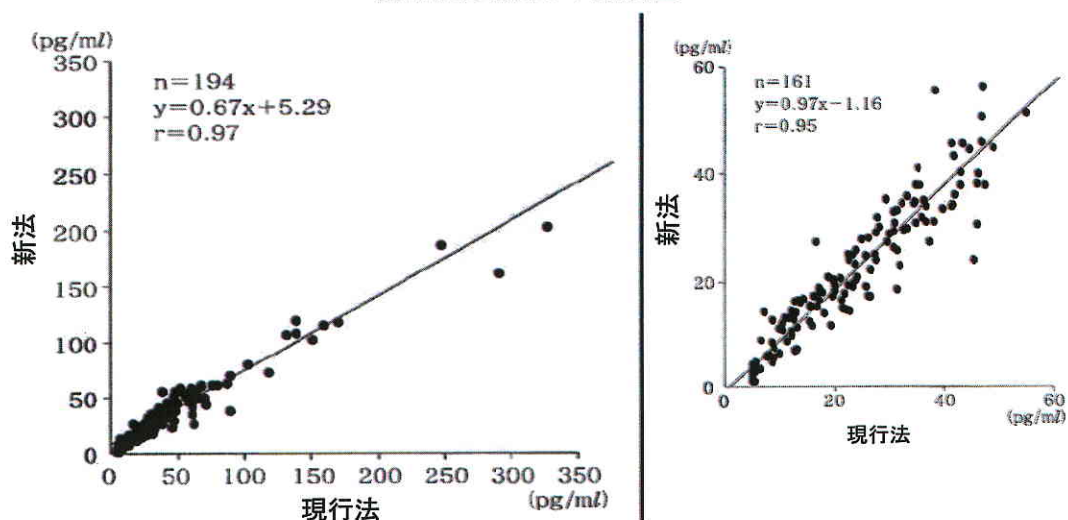

●参考文献 : 阿部 正樹, 他: 医学と薬学57(2):239~244, 2007.

お問い合わせは最寄の営業所または、  
本社・研究所にお願いいたします。

**SMS** 株式会社 昭和メディカルサイエンス

〒194-0004 東京都町田市鶴岡541-2  
TEL : 042-795-6000