



検査内容変更および報告様式変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、アミラーゼアイソザイム検査につきまして検査内容の変更をさせていただくことになりましたのでお知らせいたします。
また、併せて下記のアイソザイム検査につきましても報告様式を変更させていただくことになりましたのでご案内いたします。
何卒宜しくご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

2011年12月

◇検査内容変更項目

アミラーゼアイソザイム

[変更内容]

精度向上を目的と致しまして、検査方法の変更、及び自動化対応の測定試薬に変更致します。この変更に伴い基準範囲及びグラフ報告書の波形の表示が裏面のように変更となります。

◇報告様式変更対象項目

ALPアイソザイム

LDHアイソザイム

コレステロール分画

CPKアイソザイム

アミラーゼアイソザイム

[変更内容]

項目コードを設定し、分画内容を総合検査報告書にも出力致します。

◇実施期日

2012年1月10日(火)受付分より

※詳細は裏面をご参照下さい。

お問い合わせは最寄りの営業所または、
本社・研究所にお願いします。

SMS 株式会社 昭メテカルサイエンス
本社・研究所：東京都阿田市鶴間541番地2
TEL 042 (795) 6000



◇アミラーゼアインザイム変更内容

	変更箇所	新	現行
	AMYアインザイム	検査方法	アガロース膜
基準範囲		AMY P:15.7~64.0 % AMY S:36.0~84.3 %	AMYP1:28.4~64.0 % AMYP2: 0.0~ 7.6 % AMYS1:26.7~65.4 % AMYS2: 2.3~ 7.8 % AMY-P/S:0.12~1.42
AMYアインザイム (その他材料)	検査方法	アガロース膜	セルロースアセテート膜
	検査方法	アミ尿P:38.7~82.3 % アミ尿S:17.7~61.3 %	アミ尿P:55~90 % アミ尿S:10~45 % アミ尿-P/S:1.0~8.0

◇アミラーゼアインザイムグラフ報告書変更内容

<新>

<現行>

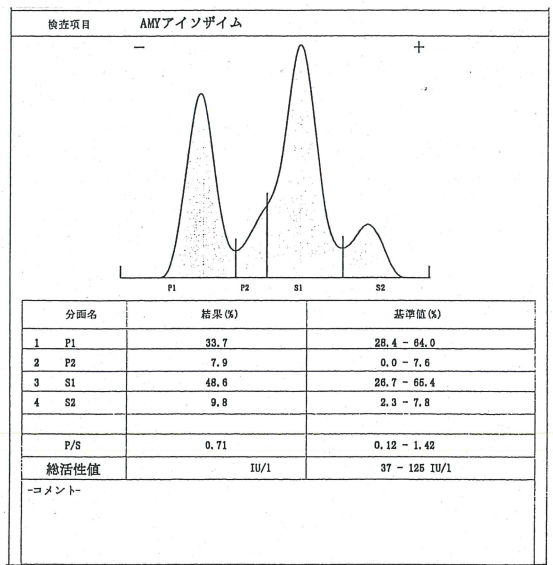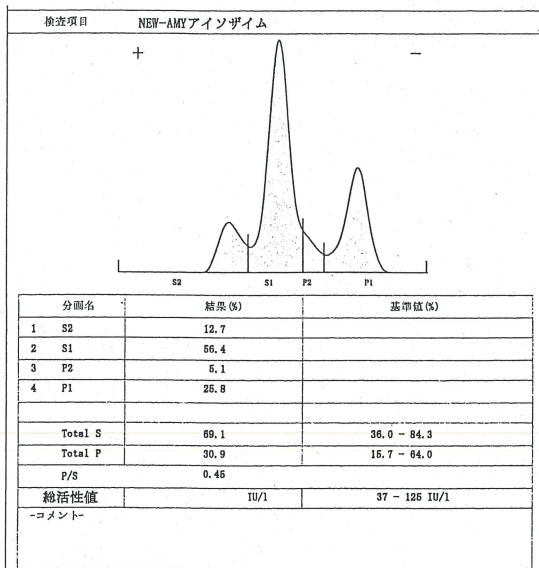

◇各種アインザイム分画子と項目コード

検査項目名	項目コード	分画子	検査項目名	項目コード	分画子
ALPアインザイム	2083	ALP1	ALPアインザイム (その他材料)	2161	ALP1 その他
	2084	ALP2		2162	ALP2 その他
	2085	ALP3		2163	ALP3 その他
	2086	ALP4		2164	ALP4 その他
	2087	ALP5		2165	ALP5 その他
	2088	ALP6		2166	ALP6 その他
CPKアインザイム	2114	CK-BB	CPKアインザイム (その他材料)	2171	CK-BB その他
	2115	CK-MB		2173	CK-MB その他
	2116	CK-MM		2174	CK-MM その他
	2156	CK-ALB		2172	CK-ALB その他
AMYアインザイム	2099	AMYP1	AMYアインザイム (その他材料)	2169	アミ尿P1
	2102	AMYP2		2170	アミ尿P2
	2100	AMYS1		2167	アミ尿S1
	2101	AMYS2		2168	アミ尿S2
	2103	TOTAL-P		2205	TOTALP-U
	2104	TOTAL-S		2206	TOTALS-U
2105	AMY-P/S	2207	アミ尿-P/S		
LDHアインザイム	2089	LDH1	コレステロール分画	7354	HDL-C
	2090	LDH2		7355	VLDL-C
	2091	LDH3		7356	LDL-C
	2092	LDH4			
	2093	LDH5			