



No.2016-20

受託中止及び検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記の検査項目につきまして、検査内容の変更及び検査受託を中止とさせていただきますこととなりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

2016年9月

◇受託中止項目

項目コード	検査項目名
4562	MHPG(3-メトキシ-4-ヒドロキシフェニルエチレングリコール)

中止期日:2016年9月29日(木)受付分をもって受託中止

◇検査内容変更項目

項目コード	検査項目名
5229	アセトアミノフェン
3664	抗ScI-70抗体精密
4548	TSAb(甲状腺刺激抗体)

変更期日:2016年9月30日(金)受付分より

※変更内容等の詳細は裏面をご参照下さい

お問い合わせは最寄りの営業所 または、
本社・研究所にお願いいたします。

SMS 株式会社 **昭和メディカルサイエンス**
本社・研究所: 東京都町田市南町田三丁目45番18号
TEL 042 (795) 6000

◇検査内容変更項目


項目コード	検査項目名	変更内容	新	現	備考
5229	アセトアミノフェン	検査方法	HEIA法	酵素法	現測定試薬販売中止による測定試薬の変更
		基準範囲	中毒域 4時間後 200 μg/mL以上 12時間後 50 μg/mL以上	肝障害域 4時間後 300 μg/mL以上 12時間後 50 μg/mL以上	
		報告範囲	5.0 μg/mL未満～最終値	1.2 μg/mL未満～最終値	
3664	抗Scl-70抗体精密	報告範囲	0.6 U/mL未満～240 U/mL以上	0.5 U/mL未満～320 U/mL以上	
4548	甲状腺刺激抗体	報告書名称	TSAb	甲状腺刺激性抗体	報告書名称の適正化

抗Scl-70抗体精密判定一致率

		従来試薬			
		陰性	判定保留	陽性	合計
新試薬	陽性	0	0	10	10
	判定保留	0	0	0	0
	陰性	110	0	0	110
合計		110	0	10	120

陽性一致率 100%
陰性一致率 100%
判定一致率 100%

自社検討資料

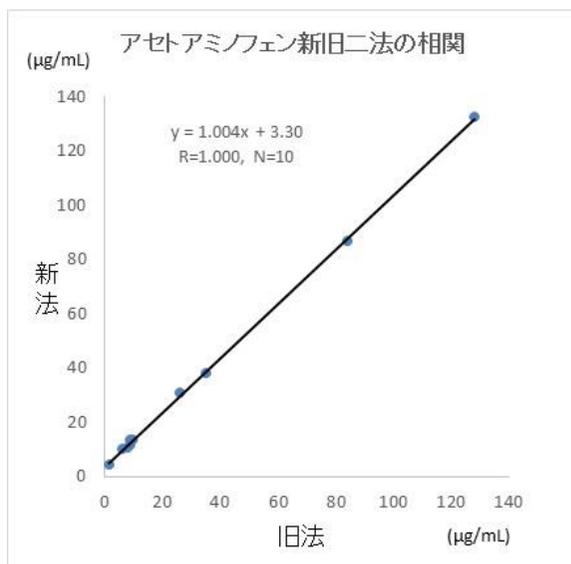

◇検査受託中止項目

項目コード	検査項目名	中止理由	関連項目
4562	MHPG	受託僅少の為	なし