

「血小板第4因子」「β-トロンボグロブリン」 容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、標記検査項目の専用容器(容器番号:④9)につきまして、従来容器販売中止のため、同一成分である CTAD 溶剤を含む採取容器に変更することとなりましたので、ご案内申し上げます。

尚、この変更により、容器に入れる血液量が 4.5mL から 3.5mL に変更になりますので、ご注意ください。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

2020 年 9 月

【記】

新容器



3.5mL


現容器



4.5mL



新容器採血量の目安

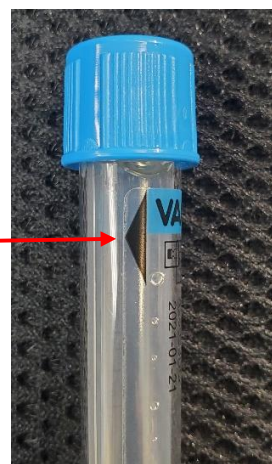

この頂点が3.5mLの目安です。

変更期日:2020 年 10 月 1 日(木)より順次切り替え